


AANSLUITING pH-SENSOR PH5510 OP CONTROLLER PH3001

KABELAANSLUITING

pH-sensor aansluiten, als er geen gebruik wordt gemaakt van de BNC connector:

pH-electrode SZ1093

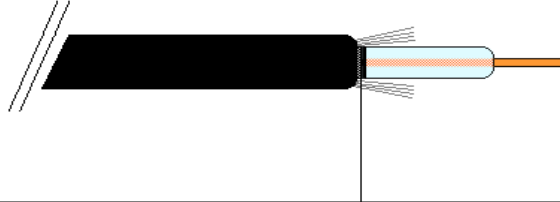

Let op, dat bij het strippen van de kabel de zwarte koolstofmantel zoveel mogelijk is weg gestript, dit kan anders problemen geven bij het meten!

Nieuwkoop BV Aalsmeer Holland

Sensor buitenmantel	16 LO
Sensor binnendraad	17 HI

NETSPANNING

9/36 Volt DC

Plus +	3
Aarde -	2

KALIBRATIE

Plaats de sensor in de pH-7 vloeistof en wacht tot de waarde stil staat.

ZERO
MODE Druk ca. 5 sec. op deze toets, display toont **Zero Cal**, gevolgd door de actuele waarde
SENS
^ of **v** Druk om te wijzigen naar de waarde van de kalibratievloeistof
ENT Druk om te bevestigen, display toont **UPDATE**

Nu de sensor schoonspoelen met demiwater en in pH-4 vloeistof plaatsen. Wacht tot de waarde stil staat.

SENS
^ Druk ca. 5 sec. op deze toets, display toont **Sens Cal** gevolgd door de actuele waarde.
Wacht op stabilisatie.

SENS
^ of **v** Druk om te wijzigen naar de waarde van de kalibratievloeistof
ENT Druk om te bevestigen, display **UPDATE**

Vervolgens sensor schoonspoelen met demiwater en nogmaals plaatsen in de pH-7 vloeistof en controleren of deze nog steeds op de juiste waarde staat. Indien dit niet het geval is dan de ijk procedure herhalen.

Plaats de sensor weer terug en de PH3001 controller is klaar voor gebruik.

Notitie: wanneer de PH3001 niet meer te kalibreren is op zowel op de pH-7 als de pH-4 vloeistof dient u de pH-sensor te vervangen.



VOLLEDIGE GEBRUIKSAANWIJZING

Scan de QR-code voor de volledige Engelse gebruiksaanwijzing.
(Volledige Nederlandse gebruiksaanwijzing niet beschikbaar)

